



國立中興大學
National Chung Hsing University

NCHU

第二季校園 第二類工作場所 訪視結果報告

National Chung Hsing University

www.nchu.edu.tw



國立中興大學
National Chung Hsing University

NCHU

「第二類工作場所訪查」 機械工程學系訪查紀錄

National Chung Hsing University

www.nchu.edu.tw



依作業場所查核表進行現場訪視(一)

國立中興大學作業場所輔導查核表 (本表請保存三年)

單位: 機械工程學系 作業場所名稱: 410-100(通線室) 檢查日期: 111年6月22日

第一節作業場所檢查重點項目; 第二節作業場所輔導查核重點項目; 第三節作業場所輔導查核重點項目

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註
*資料填寫	1 研究場所管理系統資料是否有填寫/更新。	✓	
	2 有足夠數量之手提式滅火器,其壓力及使用有效期間皆符合標準。	✓	
*消防設備	1 滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用,並有明顯標示。	✓	
	3 其他:		
*用電安全	1 儀器電源設備檢查(IX:電盤中隔板、插座是否損壞...等)。	✓	
	2 儀器電線之絕緣包層是否有破損情形。	✓	
	3 距離水槽1.8公尺內如有插座需設置穩板。	✓	
	4 其他:		
*室內整體環境	1 實驗室內禁止人員進食以及存放任何食品。	✓	
	2 儲物櫃是否有防止物品掉落之護欄,且重物宜放置在低處。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
	4 其他:		
安全衛生防護	1 是否依實驗性質所需,備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。	✓	
	2 作業人員是否配戴防護具(IX:實驗衣及安全眼鏡,不得穿拖鞋或赤腳)。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
藥品櫃	1 藥品製作危險物質清單及安全資料表(SDS)。	✓	
	2 藥品是否依法標示圖式(標示須清楚)。	✓	
	3 不相容之化學品是否分開存放,並以適當之盛盤防止洩漏。	✓	
	4 化學品使用完畢後是否有紀錄存查。	✓	
	5 列管之毒化物貯存是否上鎖管理。	✓	
排煙櫃	1 化學性操作是否在排煙櫃內進行,且拉門開口處於過度位置。	✓	
	2 櫃內是否保持清潔,不做化學品儲存櫃使用。	✓	
	3 其他:		
廢棄物處理	1 廢液是否依規定分類收集,儲存容器外標示圖式及註明內容物之成份,並置於盛盤中。	✓	
	2 生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存,標示生物醫療廢棄物標誌。	✓	
	3 貯存櫃是否遠離熱源、不易傾倒,不阻礙走道及保持清潔完整。	✓	
高壓氣體鋼瓶	1 鋼瓶是否直立存放,並採取適當固定措施,以防鋼瓶傾倒。	✓	
	2 是否有可辨識高壓氣體之鋼瓶存放,是否遠離防靜電電源、發熱源、明火及易燃物以及不相容氣體為分類存放。	✓	
	3 鋼瓶之瓶身是否過期,並依規定標示(含氣體名稱、危害警告圖式等訊息)。	✓	
	4 其他:		

作業場所負責人: 陳永承 檢查人: 吳新華蔡淑清 環安中心組長: 陳國良林正坤 環安中心主任: 陳國良林正坤

第1頁/共2頁 環境保護暨安全衛生中心 製

國立中興大學作業場所輔導查核表 (本表請保存三年)

單位: 機械工程學系 作業場所名稱: 410-100(通線室) 檢查日期: 111年6月22日

第一節作業場所檢查重點項目; 第二節作業場所輔導查核重點項目; 第三節作業場所輔導查核重點項目

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註
*資料填寫	1 研究場所管理系統資料是否有填寫/更新。	✓	
	2 有足夠數量之手提式滅火器,其壓力及使用有效期間皆符合標準。	✓	
*消防設備	1 滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用,並有明顯標示。	✓	
	3 其他:		
*用電安全	1 儀器電源設備檢查(IX:電盤中隔板、插座是否損壞...等)。	✓	
	2 儀器電線之絕緣包層是否有破損情形。	✓	
	3 距離水槽1.8公尺內如有插座需設置穩板。	✓	
	4 其他:		
*室內整體環境	1 實驗室內禁止人員進食以及存放任何食品。	✓	
	2 儲物櫃是否有防止物品掉落之護欄,且重物宜放置在低處。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
	4 其他:		
安全衛生防護	1 是否依實驗性質所需,備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。	✓	
	2 作業人員是否配戴防護具(IX:實驗衣及安全眼鏡,不得穿拖鞋或赤腳)。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
藥品櫃	1 藥品製作危險物質清單及安全資料表(SDS)。	✓	
	2 藥品是否依法標示圖式(標示須清楚)。	✓	
	3 不相容之化學品是否分開存放,並以適當之盛盤防止洩漏。	✓	
	4 化學品使用完畢後是否有紀錄存查。	✓	
	5 列管之毒化物貯存是否上鎖管理。	✓	
排煙櫃	1 化學性操作是否在排煙櫃內進行,且拉門開口處於過度位置。	✓	
	2 櫃內是否保持清潔,不做化學品儲存櫃使用。	✓	
	3 其他:		
廢棄物處理	1 廢液是否依規定分類收集,儲存容器外標示圖式及註明內容物之成份,並置於盛盤中。	✓	
	2 生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存,標示生物醫療廢棄物標誌。	✓	
	3 貯存櫃是否遠離熱源、不易傾倒,不阻礙走道及保持清潔完整。	✓	
高壓氣體鋼瓶	1 鋼瓶是否直立存放,並採取適當固定措施,以防鋼瓶傾倒。	✓	
	2 是否有可辨識高壓氣體之鋼瓶存放,是否遠離防靜電電源、發熱源、明火及易燃物以及不相容氣體為分類存放。	✓	
	3 鋼瓶之瓶身是否過期,並依規定標示(含氣體名稱、危害警告圖式等訊息)。	✓	
	4 其他:		

作業場所負責人: 王裕元(化) 檢查人: 吳新華蔡淑清 環安中心組長: 陳國良林正坤 環安中心主任: 陳國良林正坤

第1頁/共2頁

依作業場所查核表進行現場訪視(二)

國立中興大學作業場所輔導查核表 (本表請保存三年)

單位: 機械工程學系 作業場所名稱: 316-100(通線室) 檢查日期: 111年6月22日

第一節作業場所檢查重點項目; 第二節作業場所輔導查核重點項目; 第三節作業場所輔導查核重點項目

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註
*資料填寫	1 研究場所管理系統資料是否有填寫/更新。	✓	
	2 有足夠數量之手提式滅火器,其壓力及使用有效期間皆符合標準。	✓	
*消防設備	1 滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用,並有明顯標示。	✓	
	3 其他:		
*用電安全	1 儀器電源設備檢查(IX:電盤中隔板、插座是否損壞...等)。	✓	
	2 儀器電線之絕緣包層是否有破損情形。	✓	
	3 距離水槽1.8公尺內如有插座需設置穩板。	✓	
	4 其他:		
*室內整體環境	1 實驗室內禁止人員進食以及存放任何食品。	✓	
	2 儲物櫃是否有防止物品掉落之護欄,且重物宜放置在低處。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
	4 其他:		
安全衛生防護	1 是否依實驗性質所需,備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。	✓	
	2 作業人員是否配戴防護具(IX:實驗衣及安全眼鏡,不得穿拖鞋或赤腳)。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
藥品櫃	1 藥品製作危險物質清單及安全資料表(SDS)。	✓	
	2 藥品是否依法標示圖式(標示須清楚)。	✓	
	3 不相容之化學品是否分開存放,並以適當之盛盤防止洩漏。	✓	
	4 化學品使用完畢後是否有紀錄存查。	✓	
	5 列管之毒化物貯存是否上鎖管理。	✓	
排煙櫃	1 化學性操作是否在排煙櫃內進行,且拉門開口處於過度位置。	✓	
	2 櫃內是否保持清潔,不做化學品儲存櫃使用。	✓	
	3 其他:		
廢棄物處理	1 廢液是否依規定分類收集,儲存容器外標示圖式及註明內容物之成份,並置於盛盤中。	✓	
	2 生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存,標示生物醫療廢棄物標誌。	✓	
	3 貯存櫃是否遠離熱源、不易傾倒,不阻礙走道及保持清潔完整。	✓	
高壓氣體鋼瓶	1 鋼瓶是否直立存放,並採取適當固定措施,以防鋼瓶傾倒。	✓	
	2 是否有可辨識高壓氣體之鋼瓶存放,是否遠離防靜電電源、發熱源、明火及易燃物以及不相容氣體為分類存放。	✓	
	3 鋼瓶之瓶身是否過期,並依規定標示(含氣體名稱、危害警告圖式等訊息)。	✓	
	4 其他:		

作業場所負責人: 吳凱文(化) 檢查人: 吳新華蔡淑清 環安中心組長: 陳國良林正坤 環安中心主任: 陳國良林正坤

第1頁/共2頁

國立中興大學作業場所輔導查核表 (本表請保存三年)

單位: 機械工程學系 作業場所名稱: 316-100(通線室) 檢查日期: 111年6月22日

第一節作業場所檢查重點項目; 第二節作業場所輔導查核重點項目; 第三節作業場所輔導查核重點項目

檢查項目	檢查重點	檢查結果	備註
*資料填寫	1 研究場所管理系統資料是否有填寫/更新。	✓	
	2 有足夠數量之手提式滅火器,其壓力及使用有效期間皆符合標準。	✓	
*消防設備	1 滅火器、消防栓箱前是否禁止置放物品阻礙取用,並有明顯標示。	✓	
	3 其他:		
*用電安全	1 儀器電源設備檢查(IX:電盤中隔板、插座是否損壞...等)。	✓	
	2 儀器電線之絕緣包層是否有破損情形。	✓	
	3 距離水槽1.8公尺內如有插座需設置穩板。	✓	
	4 其他:		
*室內整體環境	1 實驗室內禁止人員進食以及存放任何食品。	✓	
	2 儲物櫃是否有防止物品掉落之護欄,且重物宜放置在低處。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
	4 其他:		
安全衛生防護	1 是否依實驗性質所需,備妥國家檢驗合格且足夠數量之防護具。	✓	
	2 作業人員是否配戴防護具(IX:實驗衣及安全眼鏡,不得穿拖鞋或赤腳)。	✓	
	3 定期自動檢查,並予紀錄及保存(三年)。	✓	
藥品櫃	1 藥品製作危險物質清單及安全資料表(SDS)。	✓	
	2 藥品是否依法標示圖式(標示須清楚)。	✓	
	3 不相容之化學品是否分開存放,並以適當之盛盤防止洩漏。	✓	
	4 化學品使用完畢後是否有紀錄存查。	✓	
	5 列管之毒化物貯存是否上鎖管理。	✓	
排煙櫃	1 化學性操作是否在排煙櫃內進行,且拉門開口處於過度位置。	✓	
	2 櫃內是否保持清潔,不做化學品儲存櫃使用。	✓	
	3 其他:		
廢棄物處理	1 廢液是否依規定分類收集,儲存容器外標示圖式及註明內容物之成份,並置於盛盤中。	✓	
	2 生物醫療廢棄物是否依分類、密封貯存,標示生物醫療廢棄物標誌。	✓	
	3 貯存櫃是否遠離熱源、不易傾倒,不阻礙走道及保持清潔完整。	✓	
高壓氣體鋼瓶	1 鋼瓶是否直立存放,並採取適當固定措施,以防鋼瓶傾倒。	✓	
	2 是否有可辨識高壓氣體之鋼瓶存放,是否遠離防靜電電源、發熱源、明火及易燃物以及不相容氣體為分類存放。	✓	
	3 鋼瓶之瓶身是否過期,並依規定標示(含氣體名稱、危害警告圖式等訊息)。	✓	
	4 其他:		

作業場所負責人: 謝雨萍(化) 檢查人: 吳新華蔡淑清 環安中心組長: 陳國良林正坤 環安中心主任: 陳國良林正坤

第1頁/共2頁

定期巡檢: 時間6月22~23日訪查工作場所間數10間 依作業場所查核表將缺失分類如下:

缺失分類	件數(件)	百分比
 1 資料填寫	7	38.89%
消防設備	0	0.00%
 3 用電安全	3	16.67%
室內整體環境	0	0.00%
安全衛生防護	1	5.56%
藥品櫃	2	11.11%
排煙櫃	0	0.00%
廢棄物處理	1	5.56%
 2 高壓氣體鋼瓶	4	22.22%
總計	18	100.00%




資料未填寫

本校研究場所運作管理系統:<https://safety.nchu.edu.tw/eshs/>



The screenshot shows the 'Research Site Operation Management System' (研究場所運作管理系統) interface. The header includes the NCHU logo and navigation links like '網站導覽', '國立中興大學', '環安中心', and '退出系統'. The main content area displays the '場所資料維護狀況總表' (Site Data Maintenance Status Summary Table) with a sidebar of filters (D1-D7) and a table for '學校管理者篩選功能' (School Administrator Selection Function). The table has columns for '所屬單位' (Unit), '場所負責人' (Site Responsible Person), and checkboxes for '列出已一年無任何更新者' (List those with no updates for a year), '僅列教師 (不含助教)' (List only teachers, excluding assistants), and '展開清單' (Expand list).

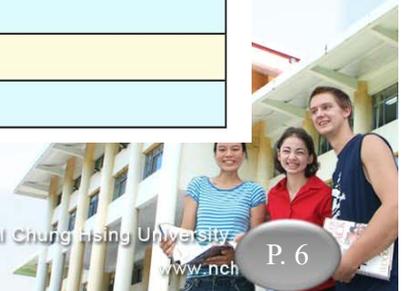

用電安全缺失照片



插座外蓋損壞，並建議將電線整理




水槽旁的插座建議加裝漏電斷路器




電線阻礙通道容易導致人員絆倒



高壓氣體鋼瓶缺失照片

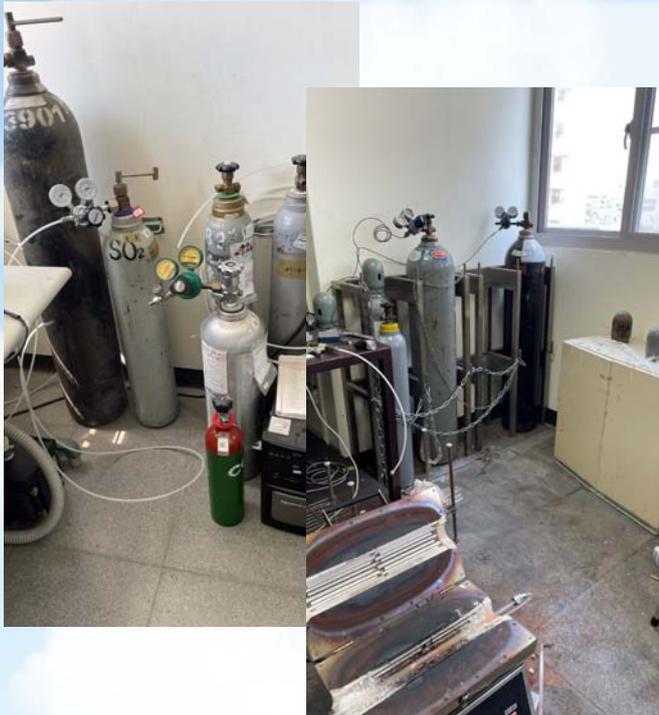

氣體鋼瓶未固定

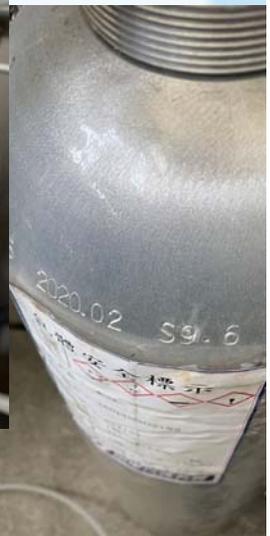

鋼瓶瓶身過期

研究場所運作管理系統-訪查暨改善紀錄

請將改善照片或資料上傳至“上傳改善紀錄”

國立中興大學 研究場所運作管理系統
National Chung Hsing University Operation Management System For Research Site

網站導覽 國立中興大學 環安中心 登錄/登出

場所資料維護 自主檢查及訪查 教育訓練 化學品管理系統資訊連結 常用連結

(C1) 自檢檢查表單 (C2) 訪查暨改善紀錄

序次	所屬單位及負責人	最近一次訪查紀錄	改善紀錄	結果狀態
1	[Redacted]	訪查日期: 2019/09/20 訪查紀錄單字號 (A000029)	未上傳改善紀錄 (A000029) 上傳改善紀錄	未結束
2	[Redacted]	-	-	-

法令查核
「國立中興大學職業安全衛生管理規章」第十七條：
工作場所負責人，應執行與其有關之下列職業安全衛生事項，並接受有關單位之督導或檢查：
一、職業災害防止計畫事項。
二、安全衛生管理執行事項。
三、定期檢查、重點檢查、檢驗及其他有關檢查督導事項。
四、定期或不定期實施巡視。
五、擬定改善工作方法。
六、擬定安全作業標準。
七、教導及督導所屬你安全作業標準方法實施。
八、督促負責人亦遵守職業安全衛生管理事項。

總結-第二類工作場所

★ 資料填寫未確實

- 請老師每年須至本中心站:<https://safety.nchu.edu.tw/eshs/> 將資料更新

★ 用電安全

- 電線橫跨走道
- 插座無外蓋

★ 高壓氣體鋼瓶

- 氣體鋼瓶未固定
- 鋼瓶瓶身已過期

謝謝聆聽 敬請指教